

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 274

Oggetto: Presa d'Atto risultanze di gara RDO /MEPA n. 1639786/2017 per l'affidamento della fornitura di n. 5 Ventilatori per Anestesia completi di monitoraggio, destinati alle UOC Anestesia e Rianimazione e UOC Ostetricia e Ginecologia p.o. Garibaldi Nesima.

Aggiudicazione definitiva alla ditta Angio Medica sas.

CIG 7147347155

SETTORE PROVVEDITORATO

Bilancio 2017

Autorizz. Di spesa n. 121 sub 1 / 2017

C.E. 01002000400

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

**Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)**

**Settore Provveditorato
Il Responsabile dell'istruttoria
(Ass. Amm.vo dott. L. Toscano)**

**Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Amministrativo Capo Settore
Provveditorato
(Dott.ssa Ersilia Riggi)**

Seduta del giorno 24 NOV. 2017

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01 agosto 2017,
giusta art.3, comma 2, L.R. N° 4 del 1 marzo 2017.

Con la presenza del:

**Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino**

e del

**Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano**

Con l'assistenza, quale Segretario del
Dott. F. G. Marangia

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che giusto Verbale di Deliberazione D.G. n 590 del 14/07/2017 è stata autorizzata l'indizione di procedura di gara attraverso RDO sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento della fornitura di N° 5 Ventilatori di anestesia completi di monitoraggio, di categoria medio-alta destinati n. 3 per il Complesso Operatorio centralizzato p.o. Garibaldi Nesima e n. 2 per l'Area Parto della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia;

Considerato che, nel rispetto delle regole del MEPA si è proceduto all'indizione, per la gara in parola, della RDO/MEPA n. 1639786 del 18/07/2017 ;

Atteso che il criterio di aggiudicazione adottato nella RDO medesima è stato quello della offerta economicamente più vantaggiosa ovvero qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 comma 9;

Riscontrati e pubblicati sulla piattaforma telematica i verbali della commissione tecnica (giusta nomina DG prot. 347 del 01/08/2017) del 04/10/2017 e del 03/11/2017 che si allegano al presente atto per farne parte integrante,

Ritenuto che ai fini dell'aggiudicazione definitiva, occorre prendere atto nonché recepire le risultanze di cui al report di aggiudicazione provvisoria del 07/11/2017 della piattaforma telematica MEPA, che si allega al presente atto per farne parte integrante, del quale si produce in stralcio graduatoria:

GRADUATORIA

BA complessiva (per n. 5 ventilatori)= €. 180.000,00 (singolo Ventilatore= €. 36.000,00)

COL. A	COL. B	COL. C	COL. D	COL. E
DITTA	Off. Costo €.	Punteggio Economico attribuito dal Sistema MEPA (max 30 pt)	Punteggio Valutazione Qualità attribuito da commissione (max 70 pt)	TOTALE PUNTI (col. C+ D)
ANGIO MEDICA	160.000,00	16,87	70,00	86,97
BURKE & BURKE	117.500,00	30,00	40,00	70,00
MAQUET ITALIA	147.914,00	21,50	32,00	53,50

Ritenuto potersi aggiudicare alla ditta Angio Medica s.a.s. di G. Mercadante la fornitura oggetto della gara, ovvero di N° 5 Ventilatori di anestesia completi di monitoraggio, per un totale di €. 160.000,00 oltre IVA 22% e per complessivi €. 195.200,00 IVA 22% inclusa;

Considerato che, per la sopra specificata gara occorre stabilire di trarre la rispettiva spesa ammontante a complessivi €. 195.200,00 IVA 22% inclusa dall'autorizzazione 121 sub 1 Conto Economico 01002000400 "Attrezzature" bilancio 2017;

Riscontrata la nota prot. 5418 del 13/11/2017 con cui il Direttore della UOC richiedente comunica, a causa dei numerosi e ripetuti guasti dei ventilatori in dotazione, la necessità di provvedere all'acquisto in somma urgenza; (in allegato)

In considerazione della urgenza medesima sopra rappresentata si propone di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività.

Su proposta del Dirigente Amministrativo Capo Settore Provveditorato che ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti;

Prendere atto nonché recepire le risultanze di cui al report di aggiudicazione provvisoria del 07/11/2017 della piattaforma telematica MEPA, che si allega al presente atto per farne parte integrante, del quale si produce in stralcio graduatoria:

GRADUATORIA

BA complessiva (per n. 5 ventilatori)= €. 180.000,00 (singolo Ventilatore= €. 36.000,00)

COL. A	COL. B	COL. C	COL. D	COL. E
DITTA	Off. Costo €.	Punteggio Economico attribuito dal Sistema MEPA (max 30 pt)	Punteggio Valutazione Qualità attribuito da commissione (max 70 pt)	TOTALE PUNTI (col. C+ D)
ANGIO MEDICA	160.000,00	16,87	70,00	86,97
BURKE & BURKE	117.500,00	30,00	40,00	70,00
MAQUET ITALIA	147.914,00	21,50	32,00	53,50

Aggiudicare e pertanto affidare alla ditta Angio Medica s.a.s. di G. Mercadante la fornitura oggetto della gara, ovvero N° 5 Ventilatori di anestesia completi di monitoraggio, per un totale di €. 160.000,00 oltre IVA 22% e per complessivi €. 195.200,00 IVA 22% inclusa;

Imputare la rispettiva spesa ammontante a complessivi €. 195.200,00 IVA 22% inclusa all'autorizzazione 121 sub 1 Conto Economico 01002000400 "Attrezzature" bilancio 2017;


Stabilire che il pagamento della somma complessiva di €. 195.200,00 IVA 22% inclusa, attinente la fornitura di che trattasi, a favore della ditta Angio Medica sas , venga effettuato entro 60 gg. dalla data di presentazione di regolare fattura, di regolare DURC acquisito da questa Azienda, previa consegna, presa in carico e collaudo delle apparecchiature fornite;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.


Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)




Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Segretario
(dott. F. G. Marangia)

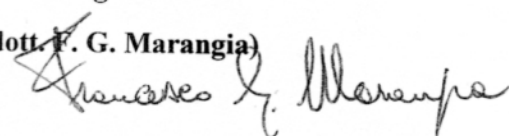

1

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno _____

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI" P.O. Nesima
Anestesia e Rianimazione
Direttore: DOTT. S. Coniglio

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO
- 4 UIT. 2017
Prot. N° 4408
ARRIVO

Al Capo Settore Provveditorato
D.ssa Ersilia Riggi
SEDE

Oggetto: Valutazione documentazione tecnica ditte partecipanti gara Workstation di Anestesia con monitoraggio.

Da una attenta lettura della documentazione tecnica delle ditte partecipanti si è evinto quanto segue:

Ditta Burke & Burke

richiesto $V_t \leftarrow$ a 20 ml in volumetrica:

dichiarato 3 ml in pressometrica a volume garantito

- a) verificare che sia stato offerto il sw neonatale in quanto opzionale (offerta senza prezzi mancanti)
- b) la PCV-VG non è una volumetrica (come descritto in relazione tecnica puntuale)
- c) nella brochure è indicato che in IMV/SIMV fanno 5ml
- d) nella scheda tecnica i 3ml li fanno in volumetrica

richiesto rapporto I:E 4:1-1:8

dichiarato 4:1-1:4 sia per volumetrica che per pressometrica.

Quindi la richiesta non è soddisfatta in tutte le modalità ventilatorie, specie quelle principali nella relazione puntuale non citano infatti il range di regolazione

richiesto picco di flusso inspiratorio maggiore o uguale a 135lt/min

dichiarato nella relazione puntuale e nella scheda tecnica 180 lt/min
nella relazione tecnica invece è indicato 120lt/min

richiesto allarmi di minima e di massima sui principali parametri monitorati con MAC e CO2
non si evince da nessuna scheda o depliant allarme su MAC

richiesto sul monitor emodinamico batteria 3ore

Il monitor Biolight Aniview A5 risponde alle 3 ore di autonomia.
Con riferimento alla miglioria indicata (modulo MPS1), la stessa ha un'autonomia di 60 min ed è priva di schermo per il trasporto (da verificare nella offerta senza prezzi mancante)

richiesto ridotti cavi di connessione al paziente

dichiarato maggiormente ridotti i cavi connessi al paziente (non rispondente; si richiedeva unico cavo per più parametri)

Alla luce delle sopraelencate note, per le evidenti difformità rilevate, è necessario chiedere alla ditta Burke & Burke di dissipare i dubbi inviando manuali di uso della Workstation di Anestesia Leon Plus e del monitor Anyview A5.

Ditta Maquet

richiesto $V_t \leq$ a 20 ml in volumetrica:

dichiarato 20-2000 ml. A volume controllato
dichiarato 5 ml in pressione controllata

richiesto rapporto I:E 4:1-1:8

dichiarato maggiore di quanto richiesto I:E 1:10-4:1

richiesto PEEP elettronica regolabile da 0 a 20 cm/H₂O

dichiarato maggiore di quanto richiesto da 0 a 50 cm/H₂O

richiesto picco di flusso inspiratorio maggiore o uguale a 135lt/min

dichiarato nella scheda tecnica maggiore di quanto richiesto 200 lt/min

richiesto sistema di sicurezza per la fornitura di alogenato e ossigeno in emergenza anche a macchina spenta

dichiarato ventilazione in modo manuale tramite valvola APL e flussimetro O₂ meccanico, non si evince erogazione di alogenati

richiesto possibilità di utilizzo di canestri di calce sodata mono uso e autoclavabile con ampia capacità

dichiarato utilizzo di canestri di calce sodata monouso e non con capacità limitata a 700 gr.

richiesto allarmi di minima e di massima sui principali parametri monitorati con MAC e CO2
non si evince da nessuna scheda o depliant allarme su MAC

richiesto ridotti cavi di connessione al paziente
non rilevabile in alcuna scheda

richiesto tutti i moduli devono essere integrati nella struttura del monitor e non devices esterni

prosto monitor modulare preconfigurato e non possibile implementazione futura di ulteriori moduli parametri

ditta Angiomedica

richiesto $V_t \leq$ a 20 ml in volumetrica:

dichiarato da 5 ml. a volume controllato (IPPV-Volume Mode) utilizzando la Ventilation Plus (verificare opzione, mancanza offerta senza prezzi)

richiesto PEEP elettronica regolabile da 0 a 20 cm/H2O

dichiarato da 0 a 20 cm/H2O

richiesto rapporto I:E 4:1-1:8

dichiarato quanto richiesto I:E 4:1-1:8

richiesto test iniziale completamente automatico per un totale controllo

dichiarato che il test non è interattivo e non richiede la presenza dell'operatore durante lo svolgimento

***richiesto sistema di sicurezza per la fornitura di alogenato e ossigeno in emergenza anche a macchina spenta**

dichiarato ventilazione di emergenza con apposito selettore meccanico anche con gas alogenati

richiesto picco di flusso inspiratorio maggiore o uguale a 135lt/min

dichiarato nella scheda tecnica maggiore di quanto richiesto superiori a 150 lt/min

richiesto allarmi di minima e di massima sui principali parametri monitorati con MAC e CO2
dichiarato di possedere gli allarmi sui parametri monitorati incluso il MAC e CO2, ma non in tutta la documentazione

richiesto monitor emodinamico multiparametrico con display TFT-LCD da almeno 12" a colori

monitor Draeger Delta XL pienamente rispondente, modulare dichiarato 8 canali configurabili, ma in alcune schede 6 canali 8 opzionale (verificare in offerta senza prezzi)

richiesto software universale per pazienti adulti, bambini e neonati. Abilitato all'uso in sala operatoria.

Dichiarato software presente e disponibile per l'uso in Sala Operatoria

Richiesto ridotti cavi di connessione al paziente

Dichiarato che il monitor è dotato di modulo Multimed con unico cavo di connessione (verificare se presente in offerta senza prezzi Cod.5950196).

In conclusione, relativamente a quanto rilevato, si richiede alla ditta Burke & Burke i dovuti chiarimenti inviando il manuale d'uso della work station di anestesia Leon Plus e del monitor Anyview A5.
Distinti Saluti


Catania, 04-10-2017

FIRMATO

Dott. Giuseppe Calabrese

Dott. Lucia Terranova

Dott. Savino Borraccino

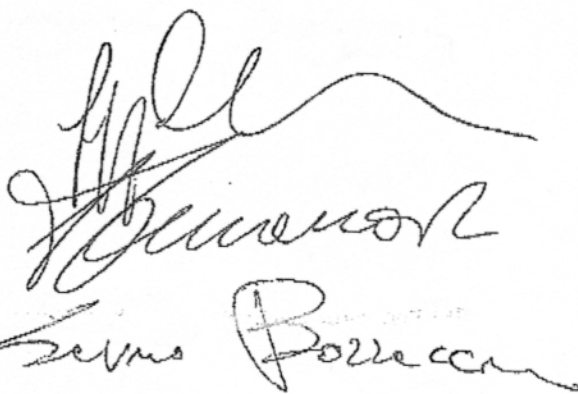

Dettaglio comunicazione

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO

Oggetto INTEGRAZIONE - 1639786 - VENTILATORI POLMONARI

Id iniziativa 1639786

Nome Iniziativa VENTILATORI POLMONARI

Mittente ERSILIA RIGGI - AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA

Testo La Commissione tecnica, ad integrazione della documentazione prodotta, richiede la trasmissione dei manuali d'uso della workstation di anestesia "LEon Plus" e del monitor Anview A5.

Allegati -

#	Destinatario	Data di invio	Data di consegna	Data di prelievo	Data di lettura
1	BURKE & BURKE	12/10/2017 11:42	12/10/2017 11:42		

INDIETRO

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
" GARIBALDI " P.O. Nesima
Anestesia e Rianimazione
Direttore: DOTT. S. Coniglio

Al Capo Settore Provveditorato
D.ssa Ersilia Riggi
SEDE

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVEDIMENTI ED ECONOMATO
- 3 NOV. 2017
Prot. N° 5286
ARRIVO

Oggetto: Valutazione documentazione tecnica ditte partecipanti gara Workstation di Anestesia con monitoraggio II^ seduta

Avendo ricevuto, come richiesto, i manuali d'uso delle apparecchiature presentate dalla ditta Burke & Burke, utili per verificare e dissipare i dubbi sorti nella prima seduta di valutazione tecnica, si relaziona quanto segue:

Ditta Burke & Burke

richiesto $V_t \leq$ a 20 ml in volumetrica:

dal manuale d'uso del produttore si evince che l'apparecchiatura in modo bambino, sia in IMV e in S-IMV, in modalità volumetrica è possibile regolare da un minimo impostabile di 3 ml (rilevato alle pag.151;156 del manuale)

richiesto rapporto I:E 4:1-1:3


dal manuale d'uso del produttore è dichiarato rapporto I:E 1:4-4:1 (non conforme alla richiesta di capitolato). (rilevato alle pag.130;154;311;312 del manuale)

richiesto picco di flusso inspiratorio maggiore o uguale a 135lt/min

dal manuale d'uso del produttore è dichiarato picco di flusso massimo 180 lt./min ((rilevato alla pag.310 del manuale)

richiesto allarmi di minima e di massima sui principali parametri monitorati con MAC e CO2

dal manuale d'uso del produttore è dichiarato allarmi di CO2 insp. ed esp. non è dichiarato allarmi regolabili sul MAC (rilevato alle pag.197;198;200;202 del manuale)

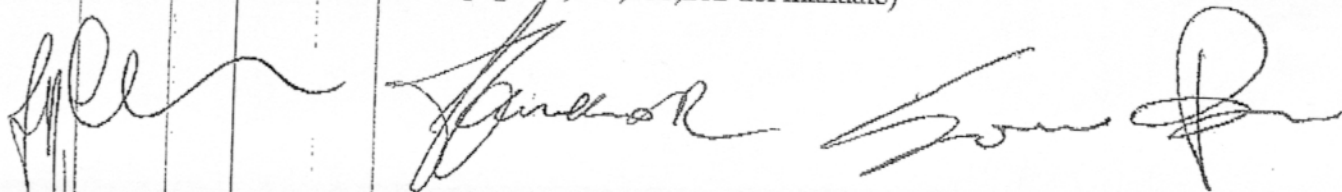

richiesto sul monitor emodinamico batteria 3orc

dal manuale d'uso del produttore è dichiarato: il monitor AnyView A5 autonomia pari o superiore a 150 min. (rilevato alla pag.257 del manuale)

Il modulo MPS autonomia 60 min. (rilevato alla pag.279 del manuale)

richiesto ridotti cavi di connessione al paziente

dal manuale d'uso del produttore si evince che per ogni parametro si utilizza un cavo proprietario e non quanto richiesto, un cavo multiparametrico per riduzione di connessioni al monitor

Restano immutate le valutazioni/considerazioni degli altri partecipanti (Maquet; Angiomedica).

Da quanto rilevato da tutte le documentazioni tecniche presentate, si assegnano i punteggi sulla qualità, verificando voce per voce della griglia, che a tal proposito si allega.

Distinti Saluti.


Catania, 27-10-2017

FIRMATO

Dott. Giuseppe Calabrese

Dott. Lucia Terranova

Dott. Savino Borraccino

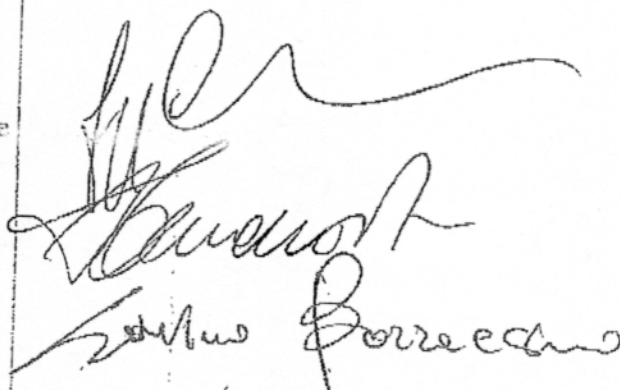

BURKE & BURKE

Ventilatore	Punteggio	NOTE
caratteristiche ventilatorie Vt in volume controllato < 20ml picco di flusso > 135lt/min no autoPEEP indotte dal ventilatore	20	Vt inf < 20ml. in volume (rilevato dal manuale 3 ml) Picco di flusso > 135lt (rilevato dal manuale 180lt./min) No autoPEEP (si)
caratteristiche generali ventilatorie test iniziale completamente automatico per valutazione delle perdite e compensazione compliance tubi paziente, e calibrazione sensori flusso e ossigeno sistema di disaccoppiamento dei gas freschi testata paziente riscaldata Possibilità di utilizzo di canestri di calce sodata monouso o canestro di calce sodata riutilizzabile con capacità uguale o superiore a 1,5 lt	10	si
sistemi di emergenza ventilatorie ventilazione in aria ambiente in caso di emergenza tipo assenza di gas centralizzati erogazione volume corrente anche in caso di guasto sensori di flusso Visualizzazione valore VM di perdite e valutazione qualitativa adeguatezza gas fresco erogato durante i bassi flussi Allarme MAC impostabile	5	-No ventilazione in aria ambiente -Si erogazione volume corrente anche guasto sensori di flusso -Si visualizzazione valore VM di perdite e valutazione qualitati tramite econometro -No allarme MAC impostabile
Sterizzabilità di tutte le componenti della testata paziente a contatto con l'esperto paziente	5	si
Monitor con possibilità di implemenazione moduli integrabili alla struttura per BIS e curarizzazione. Rilevazione della temperatura centrale corporea con metodo completamente non invasivo; Principali parametri rilevabili con unico cavo di collegamento al monitor paziente	0	-possibilità implementazione BIS e curarizzazione (rilevato dal manuale device esterni e non moduli Integrabili nella struttura. Cap 1 pg.1 - Cap.1.3 pg14) -No temperatura centrale Corporea con metodo non Invasivo -No principali parametri rilevabili con unico cavo

MAQUET

Ventilatore	Punteggio	NOTE
caratteristiche ventilatorie Vt in volume controllato < 20ml picco di flusso > 135lt/min no autoPEEP indotte dal ventilatore	15	-Vt in volume controllato minimo 20ml (non inferiore) -Picco di flusso 200lt/min -no autoPEEP indotta per tecnica volume reflector (si)
caratteristiche generali ventilatorie test iniziale completamente automatico per valutazione delle perdite e compensazione compliance tubi paziente, e calibrazione sensori flusso e ossigeno sistema di disaccoppiamento dei gas freschi testata paziente riscaldata Possibilità di utilizzo di canestri di calce sodata monouso o canestro di calce sodata riutilizzabile con capacità uguale o superiore a 1,5 lt	5	-non si evince test iniziale completamente automatico -non si evince presenza disaccoppiamento gas freschi -non si evince presenza testata paziente riscaldata -canestro di calce sodata di capacità 700gr
sistemi di emergenza ventilatorie ventilazione in aria ambiente in caso di emergenza tipo assenza di gas centralizzati erogazione volume corrente anche in caso di guasto sensori di flusso Visualizzazione valore VM di perdite e valutazione qualitativa adeguatezza gas fresco erogato durante i bassi flussi Allarme MAC impostabile	5	-nessuna possibilità di ventilare in aria ambiente (solo bombole compressore aria, soluzione qui non preferibile in ambiente di operatoria) -non si evince erogazione Vt anche in caso di guasto sensori di flusso -Visualizzazione perdite sistema VRI per bassi flussi -NON si evince allarme su MAC
Sterizzabilità di tutte le componenti della testata paziente a contatto con l'esperto paziente	2	-la cassetta paziente che è a contatto con l'esperto paziente non prevede procedura di sterilizzazione
Monitor con possibilità di implementazione moduli integrabili alla struttura per BIS e curarizzazione. Rilevazione della temperatura centrale corporea con metodo completamente non invasivo; Principali parametri rilevabili con unico cavo di collegamento al monitor paziente	5	-monitor preconfigurato per il quale non si evince possibilità implementazione di moduli BIS curarizzazione -non si evince la possibilità di monitorare la temperatura corporea centrale -Non si evince unico cavo di collegamento al monitor paziente ma solo la ridotta dimensione dei singoli cavi

ANGIOMEDICA/DRAEGER

Ventilatore	Punteggio	NOTE
caratteristiche ventilatorie Vt in volume controllato < 20ml picco di flusso > 135lt/min no autoPEEP indotte dal ventilatore	20	-Vt in volume controllato minimo 5ml -Picco di flusso 150 lt/min -no auto PEEP indotta per tecnolo pistone (SI)
caratteristiche generali ventilatorie test iniziale completamente automatico per valutazione delle perdite e compensazione compliance tubi paziente, e calibrazione sensori flusso e ossigeno sistema di disaccoppiamento dei gas freschi testata paziente riscaldata Possibilità di utilizzo di canestri di calce sodata monouso o canestro di calce sodata riutilizzabile con capacità uguale o superiore a 1,5 lt	10	-test iniziale completamente automatico per la valutazione dell perdite(SI) -presenza disaccoppiamento gas Freschi (SI) presenza testata paziente riscaldata(SI) canestro di calce sodata di capacità 1,5lt (relazione tecnica)
sistemi di emergenza ventilatorie ventilazione in aria ambiente in caso di emergenza tipo assenza di gas centralizzati erogazione volume corrente anche in caso di guasto sensori di flusso Visualizzazione valore VM di perdite e valutazione qualitativa adeguatezza gas fresco erogato durante i bassi flussi Allarme MAC impostabile	20	-possibilità di ventilare in aria ambiente grazie a tecnologia piston drive -erogazione Vt anche in caso di gu sensore di flusso(SI) Visualizzazione perdite ed econon per bassi flussi(SI) Presenza allarme su MAC (SI)
Sterizzabilità di tutte le componenti della testata paziente a contatto con l'espriato paziente	5	SI
Monitor con possibilità di implemenazione moduli integrabili alla struttura per BIS e curizzazione. Rilevazione della temperatura centrale corporea con metodo completamente non invasivo; Principali parametri rilevabili con unico cavo di collegamento al monitor paziente	15	-disponibilità moduli BIS e curizzazione (NMT) (SI) -possibilità monitoraggio tempera centrale interna non invasiva con tecnologia Tcore -unico cavo di connessione al mon tramite Multimed


Catania, 27-10-2017

u
FIRMATO

Dott. Giuseppe Calabrese

Dott.ssa Lucia Terranova

Dott. Savino Borraccino


Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1639786
Descrizione RDO:	VENTILATORI POLMONARI
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordinante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA	PGRF65
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	18/07/2017 10:02
Termine ultimo presentazione offerte:	11/09/2017 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	31/07/2017 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	11/03/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RDO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità/Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 N. 5 VENTILATORI DI ANESTESIA COMPLETI DI MONITORAGGIO

CIG	7147347155
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Ventilatori per anestesia completi di monitoraggio/5/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	180000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	BURKE & BURKE	Singola	01059590107	06/09/2017 09:08
2	ANGIO MEDICA	Singola	04380540825	08/09/2017 15:26
3	MAQUET ITALIA	Singola	03992220966	07/09/2017 17:12

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	14/09/2017 11:05:01	19/09/2017

14:44:30

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	OFFERTA SENZA PREZZI		LETTERA INVITO		CAPITOLATO TECNICO		VERSAMENTO ANAC		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BURKE & BURKE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
ANGIO MEDICA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
MAQUET ITALIA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	19/09/2017 14:44:49	07/11/2017 11:15:49

Concorrente	Offerta Tecnica (fac-simile di sistema)		SCHEDE TECNICHE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BURKE & BURKE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ANGIO MEDICA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MAQUET ITALIA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/11/2017 11:19:39	07/11/2017 12:17:38

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		OFFERTA ECONOMICA	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BURKE & BURKE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ANGIO MEDICA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MAQUET ITALIA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
-------------	----------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------	-----------------

ANGIO MEDICA	56,00 punti	70,00 punti	24,00 punti	16,97 punti	NO
BURKE & BURKE		40,00 punti		30,00 punti	NO
MAQUET ITALIA		32,00 punti		21,50 punti	NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
ANGIO MEDICA	160000,00	0,00	70,00	16,97	86,97
BURKE & BURKE	117500,00	0,00	40,00	30,00	70,00
MAQUET ITALIA	147914,00	0,00	32,00	21,50	53,50

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



P.O. Garibaldi Nesima via Palermo 511 CATANIA
U.O.C. di Anestesia e Rianimazione
Direttore Dott. Coniglio

Direttore: Tel. 095-7595240 - Medici T.I.: Tel. 095-7595246 - C.S. T.I.: Tel. 095-7595247 - Fax. 095-7595440

Al Servizio Provveditorato
Arnas Garibaldi Sede

Oggetto: Acquisto Ventilatori Anestesia

Si comunica alla S.V. l'inderogabile necessita' di provvedere all'acquisto dei ventilatori di Anestesia in somma urgenza.
In considerazione dei numerosi e ripetuti guasti dei ventilatori in Atto in uso presso il complesso operatorio

Catania 13/11/2017

Distinti Saluti

ARNAS "GARIBALDI" - P.O. NESIMA
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
Direttore: Dott. Salvatore Coniglio
Cod. ENPAM 300006530U

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVED. ED ECONOMATO
13 NOV. 2017
Prot. N° 5418
ARRIVO