

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 511

Oggetto: Aggiudicazione della procedura di gara attraverso R.D.O. sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) – R.D.O. N° 1858143 per l'acquisto di 4 dispositivi per la terapia ad alti flussi U.O.C. Neonatologia - UTIN . P.O. NESIMA CIG ZC821AB6C1

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2018</p> <p><u>C.E. 01002000400</u></p> <p>Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto:</p> <p>Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile del procedimento (Sig. Vinci Raimondo)</p> <hr/> <p>Il Responsabile del Settore Il Dirigente Responsabile c/o Settore Provveditorato (Dott.ssa Ersilia Riggi)</p>	<p>Seduta del giorno <u>11 MAG 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, comma 2, L.R. N° 4 del 01 Marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del</p> <p>Dr. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

Premesso che con deliberazione n. 385 del 21/12/2017 è stata indetta attraverso R.D.O. N° 1681919 sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) la procedura di gara per l'acquisto di di 4 dispositivi per la terapia ad alti flussi U.O.C. Neonatologia - UTIN . P.O. NESIMA ;

Considerato che, nel rispetto delle direttive sull'utilizzo del MEPA impartite dalla Direzione Generale aziendale e coerentemente con il nuovo codice appalti D.lgs 50/2016 e s.m.i., si è provveduto all'espletamento esclusivamente on line della suddetta gara sul MEPA RDO n. **1858143, CIG ZC821AB6C1**;

Visti i seguenti atti:

- Verbale della Commissione tecnica per la verifica conformità tecnica del 17/04/2018

Che, conclusa la procedura di gara, svolta sulla piattaforma MEPA, si ritiene di prendere atto delle relative risultanze, come da riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Che si ritiene opportuno aggiudicare la fornitura, previo giudizio di conformità dei prodotti offerti ed in favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , comma 4, anche in presenza di una sola offerta valida;

Che, pertanto ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , comma 4, risulta aggiudicataria la ditta Halsa s.r.l. che ha offerto quanto in gara al prezzo di € 35.200,00 oltre I.V.A. ;

Considerato che, per le fornitura del sistema di che trattasi occorre stabilire di trarre la relativa spesa di € 42.944,00 IVA comp. sul conto 01002000400 "Attrezzature Sanitarie" autorizzazione di spesa 121 sub 1;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa citati, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto dell'avvenuto espletamento da parte del Settore Provveditorato ed Economato della procedura telematica, sulla piattaforma CONSIP denominata MEPA, di cui alla relativa RDO n **1858143, CIG ZC821AB6C1** le cui risultanze, come da riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, si allegano al presente atto per farne parte integrante;

Aggiudicare la presente Gara alla ditta **HALSA s.r.l. , via Pizzo Ferro n. 8/a Pedara** che ha offerto quanto in oggetto di gara ad un prezzo di € 42.944,00 IVA inclusa;

Imputare la somma di € 42.944,00 IVA inclusa per l'acquisto di cui al presente atto sul conto **01002000400** "Attrezzature Sanitarie" autorizzazione di spesa 121 sub 1.

Dare atto che si procederà alla revoca dell'aggiudicazione nell'eventualità che gli accertamenti post gara dovessero dare esiti positivi;

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività per definire in tempi congrui la procedura di che trattasi.

Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)




Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Segretario
Dott. Francesco Giovanni Marangia

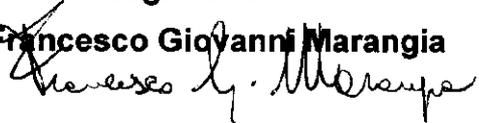

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno _____
e per i successivi 15 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1858143
Descrizione RDO:	4 DISPOSITIVI PER LA TERAPIA AD ALTI FLUSSI
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA 04721270876 PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' N.5 CATANIA CT
Punto Ordicante	ERSILIA RIGGI
Soggetto stipulante	Nome: ERSILIA RIGGI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - GARIBALDI CATANIA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	PGRF65
Inizio presentazione offerte:	02/02/2018 13:26
Termine ultimo presentazione offerte:	19/02/2018 13:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	13/02/2018 13:19
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	19/08/2018 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della BAO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 4 DISPOSITIVI PER LA TERAPIA AD ALTI FLUSSI

CIG	ZC821AB6C1
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	4 DISPOSITIVI PER LA TERAPIA AD ALTI FLUSSI/4/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	36000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	GINEVRI	Singola	03565511007	14/02/2018 17:11
2	DISPOSABLE LINE A SOCIO UNICO	Singola	05068620821	06/02/2018 16:07
3	HALSA SRL	Singola	03014960870	15/02/2018 17:41

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	23/02/2018 11:02:14	28/02/2018 08:24:33

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	DICHIARAZIONE EX ART. 80		Lettera invito capitolato		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
GINEVRI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
DISPOSABLE LINE A SOCIO UNICO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
HALSA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZO	
	Valutazione	Note
GINEVRI	Approvato	nessuna
DISPOSABLE LINE A SOCIO UNICO	Approvato	nessuna
HALSA SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inicio	Fine
	28/02/2018 08:25:03	02/05/2018 10:45:30

Concorrente	SCHEDE TECNICHE PRODOTTO	
	Valutazione	Note
GINEVRI	NON Approvato	nessuna
DISPOSABLE LINE A SOCIO UNICO	NON Approvato	nessuna
HALSA SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inicio	Fine
	02/05/2018 10:45:46	

Concorrente	OFFERTA ECONOMICA		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
GINEVRI	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
DISPOSABLE LINE A SOCIO UNICO	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
HALSA SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
HALSA SRL	35200,00
DISPOSABLE LINE A SOCIO UNICO	Concorrente escluso
GINEVRI	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

Alla cortese attenzione del Sig. Vinci
Ufficio provveditorato
PO Garibaldi Centro
Piazza S.M. Di Gesù

Sulla base delle caratteristiche fornite dalle ditte partecipanti alla gara per "Alti flussi si escludono le seguenti ditte: Ginevri e "DISPONSABLE LINE" riguardo quest'ultima si comunica note ai punti in discussione:

PUNTO 1

Il sistema a cartuccia oltre, a infondere un ottimale gas umidificato e riscaldato come la vostra apparecchiatura proposta in più permette l'eliminazione della condensa.

PUNTO 5

Le cannule nasali alti flussi cod OPT 312-OPT 314 di interesse neonatale hanno compatibilità solo con umidificatore MR 850 e non con Airvo 2 come si evince da pg 3 /3 sceda tecnica della ditta madre Fisher /Paykel .Invece tali compatibilità MR850/Airvo 2 sussiste solo con le interfacce OPT 316-OPT 318 per pazienti di peso 3-22 Kg

PUNTO 6

Si precisa che nei reparti di UTIN e neonatologia "i fini funzionali " si riferiscono anche alle dimensioni delle attrezzature; quindi, avere una batteria interna significa un minore ingombro e una maggiore maneggevolezza dell'apparecchio stesso.


Pertanto rimane conforme alle richieste il prodotto della ditta Burke e Burke

Catania, 17/4/18

Dottssa. G. Manciangli

Dottssa L.G. Tina

Dott.ssa M.G. Puleo

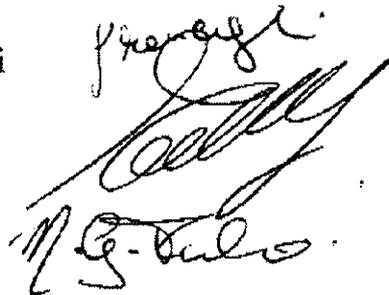

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVT. ED ECONOMATO
17 APR. 2018
Prot. N° 2110
ARRIVO